



Kalibrierausstattung

In unserem Labor stehen ein Flüssigkeitsbad, mehrere Blockkalibratoren und Rohröfen zur Verfügung. Die Erfassung der Messwerte erfolgt über den Einsatz von Agilent 3485A Multimeter.

Regelmäßige Überprüfung des Laborequipments

Alle Messgeräte, Vergleichsstellen und Normale werden jährlich DAkkS-kalibriert und sind auf nationale Normale rückführbar. Durch regelmäßige Auditierung, exakt definierte und überwachte Umgebungsbedingungen und unser geschultes Personal wird eine hohe Qualität der Kalibrierung und somit die nötige Verlässlichkeit der Messergebnisse gewährleistet.

Temperiergeräte:

- 20 / 140°C Flüssigkeitsbad mit entspr. Medium
- 80 / 125°C Trockenblockkalibrator bis Ø 6 mm
- +50 bis +600°C Trockenblockkalibrator bis Ø 6 mm
- +300 bis +1200°C Trockenblockkalibrator bis Ø 6 mm
- +200 bis +1300°C Rohröfen

Referenzsensoren:

- 80 bis +500 °C Widerstands-Thermometer mit DAkkS-Kalibrierung
- +200 bis +1300 °C Thermoelemente Typ S mit DAkkS-Kalibrierung

Vergleichsstellen: Elektronisch geregelte Eispunktthermostate mit DAkkS-Kalibrierung

Messgeräte: Digitalmultimeter HP3458 A mit DAkkS-Kalibrierung



MTS Messtechnik Schaffhausen GmbH
Mühlenstrasse 4, CH-8260 Stein am Rhein
Telefon +41 52-672 50 00
Telefax +41 52-672 50 01
www.mts.ch, e-mail: info@mts.ch

Messen Prüfen Automatisieren www.mts.ch



Unser Zertifikat

Aktuell ist das GÜNTHER Kalibrierlabor für die Messgrößen Widerstandsthermometer und Thermoelemente im Bereich von -20°C bis 600°C akkreditiert. Für Temperaturen bis 1400°C arbeiten wir mit einem Partnerlabor zusammen, das bis 1400°C akkreditiert ist. Die Erweiterung der Zulassung auf den Bereich von -80°C bis 1300°C ist bereits in Arbeit.



Unser Hauptsitz in Schwaig bei Nürnberg

Gerne beantworten wir Ihre weitergehenden Fragen rund um unser Labor, Leistungen und unsere Angebote in einem persönlichen Gespräch.

Sprechen Sie uns an!



GÜNTHER GmbH
Temperaturmesstechnik




Deutsche Akkreditierungsstelle
D-K-15220-01-00



GÜNTHER GmbH
Temperaturmesstechnik

Das GÜNTHER Kalibrierlabor
akkreditiert von der DAkkS

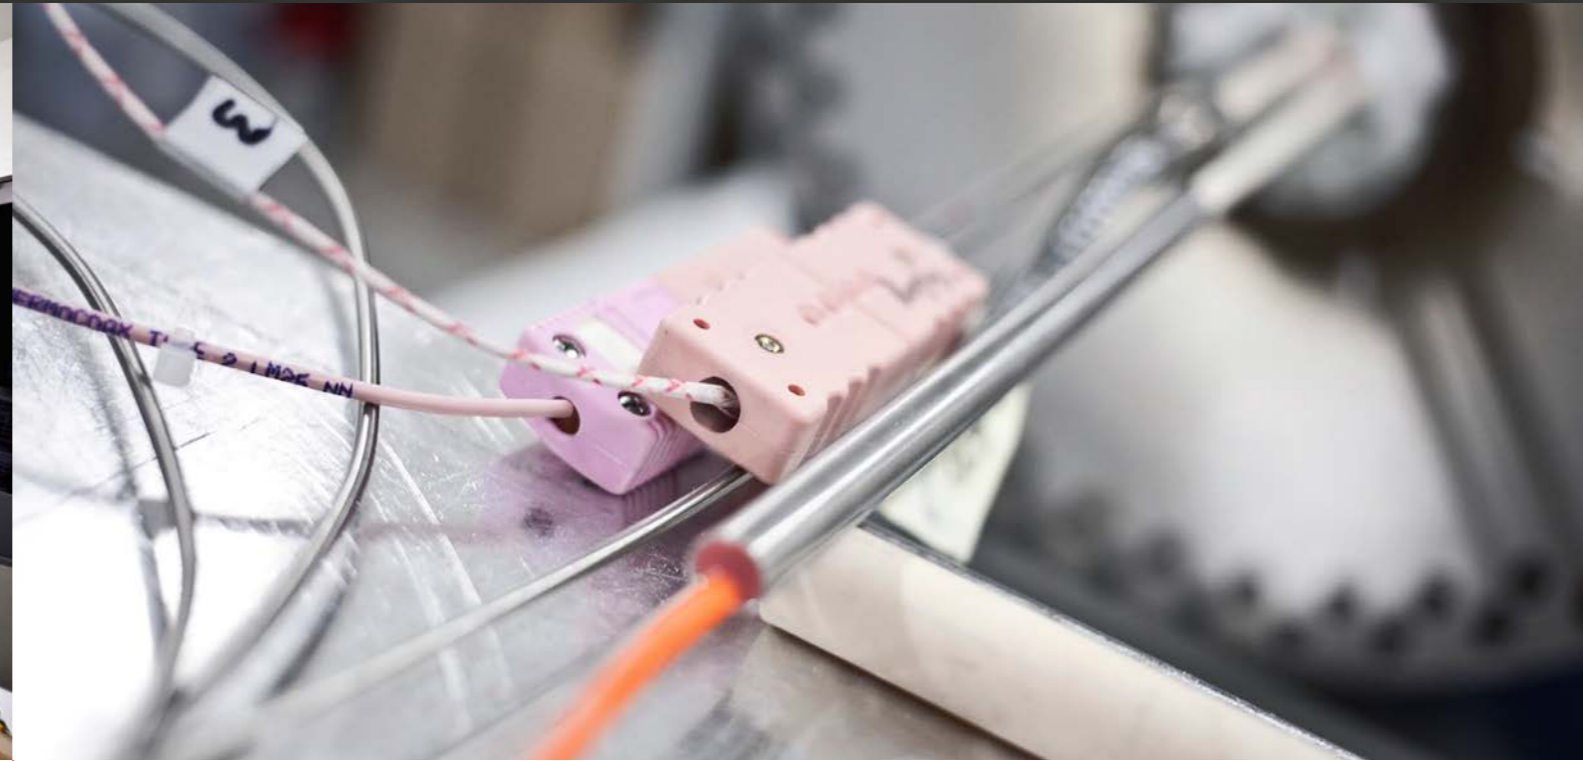

45 Jahre Leidenschaft und Präzision

Seit dem Gründungsjahr 1968 steht der Name Günther für fortschrittliche Lösungen in der Temperaturmesstechnik. Ausgehend von der Fertigung elektrischer Temperaturfühler für den Industrieofenbau, haben wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen in einer Vielzahl von Industriebereichen kontinuierlich erweitert, so dass wir uns heute zu den maßgeblichen Herstellern auf dem Gebiet der Temperaturmesstechnik zählen dürfen.

Im April 2014 wurde das seit 20 Jahren bestehende GÜNTHER-Prüflabor in unserem Hauptsitz in Schwaig bei Nürnberg von der deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS (ehem. DKD) akkreditiert.

Was ist die DAkkS?

Die DAkkS ist die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. In der Vergangenheit hatte Deutschland mehrere Gesellschaften, die auf unterschiedlichen Gebieten (Temperatur, Druck, Gewicht, usw.) akkreditierten. Nach dem 01. Januar 2010 wurden diese Gesellschaften im Zuge einer neuen europäischen Verordnung in der DAkkS fusioniert.

Nach dieser europäischen Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und dem Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG) handelt die DAkkS im öffentlichen Interesse als alleiniger Dienstleister für Akkreditierung in Deutschland. Gesetzlicher Auftrag der DAkkS ist die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen (Laboratorien, Inspektions- und Zertifizierungsstellen).

In über 4.000 Akkreditierungsverfahren begutachtet, bestätigt und überwacht die DAkkS als unabhängige Einrichtung die fachliche Kompetenz dieser Prüfstellen. Durch die Akkreditierung erfolgt die unparteiliche Bestätigung, dass die Stellen fachkundig und nach geltenden Anforderungen arbeiten. Die DAkkS prüft also die Prüfer.

Das GÜNTHER Kalibrierlabor

Im Fall des Prüflabors der GÜNTHER GmbH bedeutet die DAkkS-Zertifizierung die Verwendung genormter Messverfahren und konstant überprüfetes Kalibrierequipment. Die zur Messung verwendeten Referenzelemente und Messgeräte werden regelmäßig von einem übergeordnetem Labor neu kalibriert.

Messverfahren

In der Praxis werden Thermometer häufig in einem Vergleichsverfahren gegen ein Referenzthermometer kalibriert. Dieses Referenzthermometer wurde über weitere Vergleichsthermometer an Fixpunkttemperaturen der ITS-90 Skala kalibriert. Wesentliche Voraussetzung für das Vergleichsverfahren ist, dass das zu kalibrierende Thermometer und das Vergleichsthermometer möglichst die exakt gleiche Temperatur annehmen. Hier hat sich die Verwendung temperierter Kalibrierbäder als Messmedium bewährt.

Bei höheren Temperaturen werden spezielle, aufwändig geregelte Kalibrieröfen und Blockkalibratoren eingesetzt.

DAkkS- und Werkskalibrierungen

Die Ergebnisse der Kalibrierung werden in einem Kalibrierschein dokumentiert und der Kalibriergegenstand erhält eine Kalibriermarke.

Abhängig von der Anforderung wählt man zwischen einer DAkkS- oder einer Werkskalibrierung:

DAkkS-Prüfscheine dürfen nur von akkreditierten Labor erstellt werden, sind in der Richtlinie DkkS-DKD-5_20101221_v1.2_0 geregelt und somit einheitlich. Die Anforderungen von DkkS-DKD-5 sind für alle Kalibrierlabore der Deutschen Akkreditierungsstelle verbindlich. Ein entsprechend ausgefüllter Kalibrierschein erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO/IEC 17025:2005 an Kalibrierscheine und dokumentiert die Rückführung auf die SI-Einheiten. Ein Werksprüfschein ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204.

Ihre Vorteile:

- Hohe, gleichbleibende Qualität durch externe Überwachung
- Unabhängige, regelmäßige Zertifizierung von Labor und Material
- Höchst verlässliche Messergebnisse der Kalibrierung
- Rückführung auf nationale und internationale Normale
- International anerkannte Kalibrierergebnisse
- Kalibrierung nach national und international gültigen Normen und Vorschriften

Die Kalibrierung von Thermoelementen und Widerstandsthermometern kann in unserem Labor ab sofort in den nachfolgend aufgeführten Temperaturbereichen nach den offiziellen DAkkS-Richtlinien durchgeführt werden:

Messgröße/ Kalibriergegenstand	Messbereich/ Messspanne	Messbedingungen/ Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit	Bemerkungen
Widerstandsthermometer	-20°C bis +100°C	Thermostatisiertes Flüssigkeitsbad	0,1 K	gemäß DAkkS / DKD 5-1
	-20°C bis +200°C	Temperaturblock-Kalibrator	0,3 K	
	>200°C bis +500°C		1,0 K	
Edelemetal- Thermoelemente	-20°C bis +100°C	Thermostatisiertes Flüssigkeitsbad	0,7 K	gemäß DAkkS / DKD 5-3
	-20°C bis +500°C	Temperaturblockkalibrator	1,5 K	
	≥200°C bis +600°C	Rohröfen	1,5 K	
Nicht-Edelmetall- Thermoelemente	-20°C bis +100°C	Thermostatisiertes Flüssigkeitsbad	0,7 K	gemäß DAkkS / DKD 5-3
	-20°C bis +500°C	Temperaturblockkalibrator	1,5 K	
	≥200°C bis +600°C	Rohröfen	1,5 K	

Werksprüfscheine können im Bereich von -80°C bis 1300°C erstellt werden.

